



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 6281/03.03.2015

Nr. de exemplare :1  
Exemplar nr. 1

### CLARIFICARI

privind procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de furnizare dotări și echipamente medicale din cadrul proiectului “ Ambulatoriul de specialitate al spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi”, cod SMIS 19732

La solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractantă formulează următoarele clarificări:

#### Solicitarea nr. 1:

„Fișa tehnica nr.6

SISTEM DE RADIOGRAFIE DIGITALĂ

1. Capitolul 1.

Caracteristici tehnice generale:

- Ansamblu tubului cu raze X/colimatorului este întotdeauna centrat pe detectorul digital si montat pe o coloana cu braț în formă de U.

Solicitare clarificare:

Vă rugăm să acceptati ca variante oferite si solutiile cu tubul montat pe coloana si detectorul digital fix sau wireless.”

#### Răspuns nr. 1:

Se acceptă atât varianta cu detector fix cât și wireless.

#### Solicitarea nr. 2:

„Fișa tehnica nr.6

SISTEM DE RADIOGRAFIE DIGITALĂ

2. Capitolul 1:

Caracteristici tehnice:

- Rotația motorizată a tubului (min -15° până la +120°).

Solicitare clarificare:

Vă rugăm sa acceptati si solutia de miscare motorizata a tubului pe axa Y si rotatia manuala in jurul acestei axe.”

#### Răspuns nr. 2:

Conform răspunsului publicat în SEAP la clarificarea nr. 2 din 19.02.2015:

Se mentine cerinta de rotatie motorizată a tubului. Se acceptă și posibilitatea rotatiei manuale a tubului. Nu se accepta rotatia exclusiv manuală a tubului. Rotatia tubului este solicitată pe axa y.

**Solicitarea nr. 3:**

„Fișa tehnica nr.6  
SISTEM DE RADIOGRAFIE DIGITALĂ  
3. Capitolul 1

Generator :

- Interval mAs: 0,5 pana la 1000 mAs

Solicitare clarificare:

Va rugam sa acceptati un domeniu mAs mai puțin restrictiv, de min: 0,5-800 mAs.”

**Răspuns nr. 3:**

**Conform răspunsului publicat în SEAP la clarificarea nr.2 din 19.02.2015:**

**Se mentine cerința: minim 0,5-1000 mAs .**

**Solicitarea nr. 4:**

„Fișa tehnica nr.6  
SISTEM DE RADIOGRAFIE DIGITALĂ  
4. Capitolul1

Detector:

- Dimensiunea câmpului activ al detectorului: 43x43 cm.

Solicitare clarificare:

Va rugam sa acceptati si ofertarea de detectori rectangulari de min. 35x43 cm.”

**Răspuns nr. 4:**

**Conform răspunsului publicat în SEAP la clarificarea nr.2 din 19.02.2015:**

**Se mentine cerinta cu mentiunea: minim 43x43cm**, deoarece aceste dimensiuni ale detectorului permit micșorarea timpului de manipulare a echipamentului nefiind necesara schimbarea detectorului din pozitia portrait in pozitia landscape optimizand astfel investigatia si fluxul de pacienti.

**Solicitarea nr. 5:**

„Fișa tehnica nr.6  
SISTEM DE RADIOGRAFIE DIGITALĂ  
5. Capitolul 1:

Detector:

- Matricea activa a pixelilor: 2869x2874.

Solicitare clarificare:

In conditiile acceptarii variantei de detector rectangular de min 35x43 cm, vă rugam sa acceptati si rezolutia corespunzatoare acestei solutii de min 3030 x 2500 pixelli.”

**Răspuns nr. 5:**

**Conform răspunsului publicat în SEAP la clarificarea nr.2 din 19.02.2015:**

**Se mentine cerinta: minim 2869x2874 pixeli.** Matricea va fi corespunzatoare realizarii unei rezolutii spatiale de min 3 lp/mm.

**Solicitarea nr. 6:**

„Fișa tehnica nr.7:  
Echograf Digital Doppler Color de Inalta performanta  
1. Capitolul 1

**CONFIGURATIA SISTEMULUI:**

6. Tranductor sectorial electronic: 1 buc

Gama de frecvente: 2,0-5,0 Mhz

Solicitare de clarificari:

Va rugam sa acceptati si varianta de traductor de tip passed array, cu format de imagine sectorial electronic, cu o gama de frecvente de min. 2,0-4,0 Mhz.”

**Răspuns nr. 6:**

**Conform răspunsului publicat în SEAP la clarificarea nr.2 din 19.02.2015:**

**Se menține cerința cu mențiunea: gama de frecvență: minim 2,0-5,0 Mhz.**

**Solicitarea nr. 7:**

„Fișa tehnica nr.7:

Echograf Digital Doppler Color de Inalta performanta

2. Capitolul 2:

MODURI DE VIZUALIZARE SI OPERARE


Modul M-anatomic de examinare(optiune ulterioara)

Solicitare de clarificare:

Avand in vedere ca aceasta optiune nu se solicita la acest moment, va rugam sa eliminati aceasta solicitare din Caietul de sarcini.”

**Răspuns nr. 7:**

**Se menține cerința din caietul de sarcini: Modul M anatomic de examinare(optiune ulterioara).**

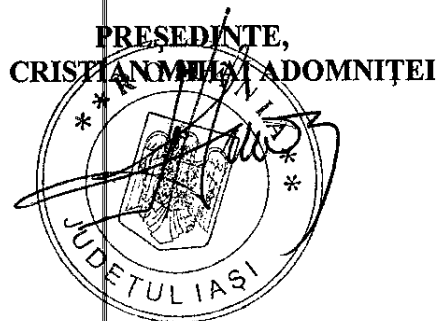

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ANCA MUȘCHERU**

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității  
în solidar cu întocmitorul înscrisului*

**ȘEF SERVICIU,**

**Iulia-Ramona ANTONESEI-ROPCEAN**

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității  
în solidar cu întocmitorul înscrisului*

**Consilier,**

**Carmen ANDREI**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,  
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*