



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



2

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



### PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU” la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

Referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU” la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 46227/27.11.2023;

Nota de fundamentare nr. 35276/22.11.2023, întocmită de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, transmisă cu adresa nr. 35278/22.11.2023, la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU” la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 45513/22.11.2023;

Raportul de specialitate la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU” la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, înregistrat sub nr. 46228/27.11.2023;

Avizul nr. 13 din 22.11.2023 al Consiliului Tehnico Economic din cadrul Consiliului Județean Iași prin care s-a avizat favorabil Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU” la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași;

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Prevederile art. 173, alin(1), lit.b) și alin(3), lit.f) din Ordonanța nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.182 alin(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU” la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, după cum urmează:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general.

	Valoare lei (fără TVA)	Valoare lei (cu TVA)
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>795.037,87</b>	<b>810.237,87</b>
<b>din care: C+M</b>	<b>715.037,87</b>	<b>715.037,87</b>

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Spitalul Sf. Maria din Iași este un complex spitalicesc de urgențe pediatrice. În cadrul acestuia, pentru o mai bună funcționare a serviciilor medicale furnizate, se propune amenajarea Secțiilor de Radiologie în corpul A și în corpul B, la parter și primul nivel.

Prin măsurile adoptate conform DALI-ului nu se intervine și nu sunt afectate lucrările executate în cadrul proiectului de Reabilitare și Modernizare a Spitalului Sf. Maria Iași.

Prin soluția proiectată se dorește corelarea echipamentelor și funcționalului cu legislația în vigoare privind cerințele de calitate în construcții: rezistență mecanică și stabilitate, siguranță în exploatare, securitatea la incendiu, igienă, sănătate și mediu, economie de energie și izolare termică, protecția împotriva zgomotului.

**Date tehnice:**

- asigurarea ecranării spațiului conform calculului de radioprotecție, fără a include tavanele, întrucât grosimea planșelor asigură protecția necesară;
- turnarea unei șape autonivelante, astfel încât podeaua să prezinte o planeitate de maximum 1mm/m;
- montarea PVC/linoleum antistatic;
- montarea butoanelor de urgență, lămpilor de avertizare, butonului on/off;
- montarea contactului magnetic la nivelul ușilor;
- asigurarea unui geam plumbat între camera de examinare și cea de comandă conform calculului de radioprotecție.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Scopul proiectului este îmbunătățirea serviciilor medicale și diminuarea timpului de așteptare pentru investigații imagistice, prin intervenții ce respectă normele și prevederile legislației în vigoare.

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 6 luni

**Art. 2.** Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:

- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Direcției Economice – Serviciul Buget;
- Direcției Tehnice și Investiții;
- Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași


**Art 3.** Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi: \_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE,**  
**Costel ALEXE**



**Vizat pentru legalitate,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
**Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU**



**DIRECȚIA JURIDICĂ,**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**


Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum  
responsabilitatea asupra legalității

**Gabriela ALUNGULESEI**

**DIRECȚIA TEHNICĂ SI INVESTITII**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității  
în solidar cu întocmitorul înscrisului

**Iogen GÎNJU**



**SUSȚINE PROIECTUL DE HOTĂRÂRE ,**  
Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sfânta  
Maria” Iași

**Bioing. Alina BELU**

**ÎNTOCMIT**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinii  
legalitatea înocinini acestui înscris oficial

**Monica VASILACHE**





ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 46227/27.11.2023

**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU" la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași**

Având în vedere:

Nota de fundamentare nr. 35276/22.11.2023, întocmită de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, transmisă cu adresa nr. 35278/22.11.2023, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU" la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 45513/22.11.2023;

Avizul nr. 13 din 22.11.2023 al Consiliului Tehnico Economic din cadrul Consiliului Județean Iași prin care s-a avizat favorabil Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU" la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași;

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Prevederile art. 173, alin(1), lit.b) și alin(3), lit.f) din Ordonanța nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.182 alin(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de cele prezentate, propun dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Iași Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU" la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași.

INITIATOR,  
PREȘEDINTE,  
Costel ALEXE





ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 46228 / 27.11. 2023

## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU" la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași**

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași este un complex spitalicesc de urgențe pediatrice. În cadrul acestuia, pentru o mai bună funcționare a serviciilor medicale furnizate, se propune amenajarea Secțiilor de Radiologie în corpul A și în corpul B, la parter și primul nivel.

Prin măsurile adoptate conform Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nu se intervine și nu sunt afectate lucrările executate în cadrul proiectului de Reabilitare și Modernizare a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași.

Prin soluția proiectată se dorește corelarea echipamentelor și funcționalului cu legislația în vigoare privind cerințele de calitate în construcții: rezistență mecanică și stabilitate, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu, igienă, sănătate și mediu, economie de energie și izolare termică, protecția împotriva zgomotului.

### DATE TEHNICE:

- asigurarea ecranării spațiului conform calculului de radioprotecție, fără a include tavanele, întrucât grosimea planșeelor asigură protecția necesară;
- turnarea unei șape autonivelante, astfel încât podeaua să prezinte o planeitate de maximum 1 mm/m;
- montarea PVC/linoleum antistatic;
- montarea butoanelor de urgență, lămpilor de avertizare, butonului on/off;
- montarea contactului magnetic la nivelul ușilor;
- asigurarea unui geam plumbat între camera de examinare și cea de comandă conform calculului de radioprotecție;

În prezent, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași beneficiază de o reabilitare majoră, însă aceasta nu acoperă și infrastructura aferentă serviciilor de radiologie, în concluzie spațiile reabilite nu permit desfășurarea procesului medical menționat, în condițiile legislative impuse.

Prin avizul nr. 13 din 22.11.2023 al Consiliului Tehnico Economic din cadrul Consiliului Județean Iași prin care s-a avizat favorabil Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU" la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași.

Având în vedere cele menționate, solicităm aprobarea în plenul Consiliului Județean Iași a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții **“AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU”** la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași

Anexăm prezentului raport de specialitate:

Avizul nr. 13 din 22.11.2023 al Consiliului Tehnico Economic din cadrul Consiliului Județean Iași prin care s-a avizat favorabil Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții **“AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU”** la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași.

**DIRECTOR EXECUTIV**

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii  
și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

**Iogen GÎNJU**



*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea  
corectitudinea legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*

**Întocmit,**

**Monica VASILACHE**



22 11 2023 31278



ROMÂNIA




JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI



ANMCS

unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; [www.sfmaria-iasi.ro](http://www.sfmaria-iasi.ro)

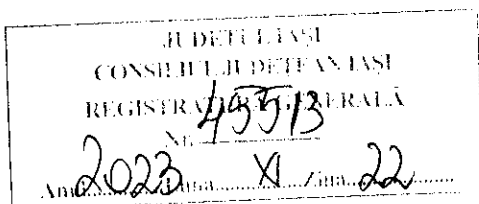

DTI  
UP

Catre

CONSILIUL JUDETEAN IAȘI

Prin prezenta adresa , va transmitem anexat Notele de Fundamentare pentru:

- proiectul de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii” AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU”
- proiectul de hotarare privind aprobarea Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii”Extindere instalatie electrica Corp B , Et 1 – Sectia Radiologie si Corp A , Parter – Sectia UPU , Bucatarie , Spalatorie , Conectare la utilitati a echipamentelor”

MANAGER

Bioing. ALINA BELU

Vasilescu

23.11.2023



22

31276  
11 23

ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI

ANMCS

unitate afiliată în  
PROCES DE ACRUITAREAdresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; [www.sfmaria-iasi.ro](http://www.sfmaria-iasi.ro)**NOTA DE FUNDAMENTARE**

**La proiectul de hotarire privind aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii” AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU”**

**1.INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:**

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general:

	Valoare (fara TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (cu TVA) Lei
TOTAL AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA ȘI CAMERA RADIOLOGIE UPU – IN CADRUL SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “SF MARIA” IASI	795.037,87	15.200,00	810.237,87
TOTAL Constructii + Montaj	715.037,87	0	715.037,87

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Spitalul Sf. Maria din Iasi este un complex spitalicesc de urgente pediatrice. In cadrul acestuia, pentru o mai buna functionare a serviciilor medicale furnizate, se propune amenajarea Sectiilor de Radiologie in corpul A si in corpul B, la parter si primul nivel.

Prin măsurile adoptate conform DALI-ului nu se intervine și nu sunt afectate lucrările executate în cadrul proiectului de Reabilitare și Modernizare a Spitalului Sf. Maria Iași.

Prin soluția proiectată se dorește corelarea echipamentelor și funcționalului cu legislația în vigoare privind cerințele de calitate în construcții: rezistență mecanică și stabilitate, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu, igienă, sănătate și mediu, economie de energie și izolare termică, protecția împotriva zgomotului.

**. Date tehnice:**

- asigurarea ecranării spațiului conform calculului de radioprotecție, fără a include tavanele, întrucât grosimea planșelor asigură protecția necesară;
- turnarea unei sape autonivelante, astfel încât podeaua să prezinte o planeitate de maximum 1 mm/m;
- montarea PVC/linoleum antistatic;
- montarea butoanelor de urgență, lămpilor de avertizare, butonului on/off;
- montarea contactului magnetic la nivelul ușilor;
- asigurarea unui geam plumbat între camera de examinare și cea de comandă conform calculului de radioprotecție;

a) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

În conformitate cu prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, analiza economică se realizează pentru proiecte majore ale cărui cost depășește echivalentul a 25 milioane euro în cazul investițiilor promovate în domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investițiilor promovate în alte domenii.

b) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de realizare lucrărilor de execuție este de 6 luni de la încheierea contractului de lucrări.

## **2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI**

În prezent Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Sf. Maria din Iași beneficiază de o reabilitare majoră, însă aceasta nu acoperă și infrastructura aferentă serviciilor de radiologie, în

concluzie spațiile reabilitate nu permit desfășurarea procesului medical menționat, în condițiile legislative impuse.

În consecință vă rugăm să aprobați indicatorii tehnico – economice pentru proiectul de investiții propus.

MANAGER  
Bioing. ALINA BELU




COMP. TEHNIC  
Ing. CALIN SCHAAS



**CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**  
Consiliul Tehnico - Economic

SE APROBĂ  
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PREȘEDINTE C. J. IAȘI

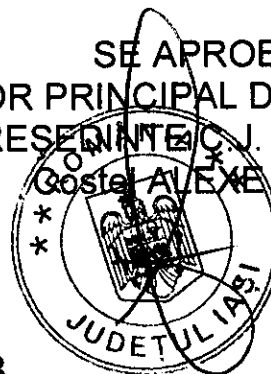

**AVIZ**

**Nr. 13 din 22.11.2023**

Temeiul legal – HOTĂRÂREA C.J. Iași nr. 361 / 29.10.2013 cu modificările și completările ulterioare

**CONSILIUL TEHNICO- ECONOMIC**  
**AVIZEAZĂ FAVORABIL**

**Denumirea proiectului obiectivului de investiții:**

**AMENAJARE SPAȚIU LABORATOR DE RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ  
MEDICALĂ ȘI CAMERĂ RADIOLOGIE UPU**

**Faza : D.A.L.I.**

**Ordonator de credite / beneficiar: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii  
"Sfânta Maria" Iași**

**a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general.**

	Valoare lei (fără TVA)	Valoare lei (cu TVA)
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>795.037,87</b>	<b>810.237,87</b>
<b>din care: C+M</b>	<b>715.037,87</b>	<b>715.037,87</b>

**b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.**

Spitalul Sf. Maria din Iași este un complex spitalicesc de urgențe pediatrice. În cadrul acestuia, pentru o mai bună funcționare a serviciilor medicale furnizate, se propune amenajarea Secțiilor de Radiologie în corpul A și în corpul B, la parter și primul nivel.

Prin măsurile adoptate conform DALI-ului nu se intervine și nu sunt afectate lucrările executate în cadrul proiectului de Reabilitare și Modernizare a Spitalului Sf. Maria Iași.

Prin soluția proiectată se dorește corelarea echipamentelor și funcționalului cu legislația în vigoare privind cerințele de calitate în construcții: rezistență mecanică și stabilitate, siguranță în exploatare, securitatea la incendiu, igienă, sănătate și mediu, economie de energie și izolare termică, protecția împotriva zgomotului.

**Date tehnice:**

- asigurarea ecranării spațiului conform calculului de radioprotecție, fără a include tavanele, întrucât grosimea planseelor asigură protecția necesară;
- turnarea unei șape autonivelante, astfel încât podeaua să prezinte o planeitate de maximum 1mm/m;
- montarea PVC/linoleum antistatic;
- montarea butoanelor de urgență, lămpilor de avertizare, butonului on/off;
- montarea contactului magnetic la nivelul ușilor;
- asigurarea unui geam plumbat între camera de examinare și cea de comandă conform calculului de radioprotecție.


**c)Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.**

Scopul proiectului este îmbunătățirea serviciilor medicale și diminuarea timpului de așteptare pentru investigații imagistice, prin intervenții ce respectă normele și prevederile legislației în vigoare.

**d)Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 6 luni**

Documentația a fost avizată în ședința C.T.E. din data de **20.11.2023**. (Proces Verbal nr. 6).

**Președinte C.T.E.**  
**Marius-Sorin DANGĂ**



**Monica VASILACHE**  
*Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea  
corectitudinea legalitatea întocmirii acestui in scris oficial*  
**Secretar supleant C.T.E.**

